

Anew®

اللغة العربية

إرشادات الاستخدام

الغرض من الاستخدام

يمكن استخدام قناع SleepWeaver لتوفير وصلة لضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) أو لتوفير علاج ثانٍ المستوى. هذا القناع معد لإعادة الاستخدام من قبل مريض واحد في المنزل وفي بيئه المستشفى/المؤسسات. ينبغي استعمال هذا القناع على المرضى الذين يزيد وزنهم عن 66 رطلاً/كجم.




تهيئة القناع

1. أخرج قناع SleepWeaver Anew من العبوة.
2. افهم التهيئة الصحيحة للقناع:

 - أ. وصلة فموية تغطي فك
 - 1. تتوり على مرفق ذي صمام مانع للاختناق (AAV) منحنٍ بزاوية 90°
 - 2. تحيط على فتحات للزفير
 - 3. تحيط على أحجام القناع (صغير، متوسط، كبير)
 - ب. وصلة أنفية تعطي انفك



تركيب القناع

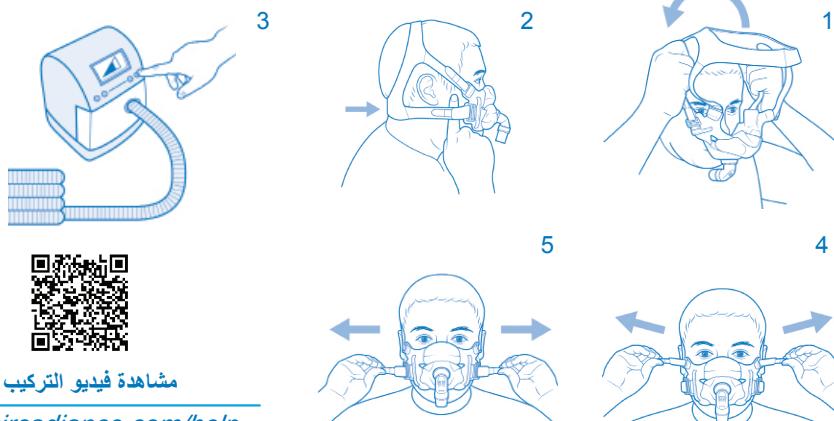

مشاهدة فيديو التركيب

www.circadiance.com/help

العنوان الفعلي: 1010 Corporate Lane Export, PA 15632

فنيات الهاون: 1 724-858-2837 888-825-9640
www.circadiance.com info@circadiance.com

التنبيهات

- يرجى الرجوع إلى دليل جهاز العلاج للحصول على تفاصيل بشأن معلومات حول الإعدادات والتشغيل.
- تقدم الموصفات الفنية للقناع إلى موفر الرعاية الخاص بك لتفقد مدى تواافقها مع جهاز العلاج. وفي حال الاستخدام خلافاً للموصفات، فقد لا يكون القناع مريحاً ومحكم الغلق، وقد لا تتحقق تجربة العلاج المثلى، وقد يؤثر التسرب أو التغيير في معدل التسرب على وظيفة الجهاز.

- يجب تنظيف القناع يومياً لمنع التلوث بالتراب والزيت المترافقين من الجلد على القناع.

- لا ينبغي تنظيف القناع بطرق تنظيف أو تطهير غير معتمدة.

- يجب على المستخدم تنظيف وجهه قبل ارتداء القناع.

- ينبغي للمستخدم عدم تغيير تصميم القناع.

- لا وضع القناع في مufff الملابس.

موانع الاستعمال

- لم يُصمم قناع SleepWeaver Anew للاستخدام من قبل المرضى الذين يتناولون عقاقير موصوفة قد تؤدي إلى حدوث قيء.

- قد لا يكون قناع SleepWeaver Anew مناسباً للأشخاص الذين يعانون الحالات التالية:
ضعف عضلة المصاصة القلبية أو انحسار مفرط أو ضعف الانتعاش السعالي أو الفتق الحجابي.

الموصفات الفنية

- 1. نطاق العلاج بالضغط

- 4 إلى 30 سنتيمتر من الماء

- 2. المقاومة (هيروط الضغط) مع عدم سماح صمام (AVV) بمرور الهواء @ 50 لتر/دقيقة = 0.3 سنتيمتر من الماء

- 3. المقاومة الشبهية والزفيرية مع سماح صمام (AVV) بمرور الهواء @ 100 لتر/دقيقة = 0.4 سنتيمتر من الماء

- 4. تشغل الصمام المانع للاختناق (AAV):
السماح بمرور الهواء @ 50 لتر/دقيقة = 1.8 سنتيمتر من الماء الزفير @ 50 لتر/دقيقة = 1.7 سنتيمتر من الماء

- 5. معدل التسرب الثابت (قد يختلف التدفق باختلاف التصنيع):

النفخ (لتر في الدقيقة)	الضغط (سنتيمتر من الماء)						
30	25	20	15	10	5	4	
67	58	50	41	30	18	16	

- 6. ليس من المتوقع أن يؤثر التخزين البيئي وظروف التشغيل في وظائف هذا الجهاز.

- 7. مستويات الصوت

- مستوى ضغط الصوت ذو الترجيح-A @ 1 متراً، 29 ديبسيبل مرجح-A

- مستوى ضغط الصوت ذو الترجيح-A @ 22 مم.

- 8. وصلة متراوحة بقياس 22 مم.

- 9. من المتوقع أن يظل هذا الجهاز مناسباً للاستخدام والتقطيف العادي لفترة لا تقل عن 90 يوماً.

- 10. لم يصنع الجهاز بواسطة لاتكس مطاطي طبيعي.

www.circadiance.com/help الضمان المحدود



0459

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP لاهاي،
هولندا




تابع تركيب القناع

1. ضع القناع عن طريق سحبه وغطاء الرأس فوق رأسك.
- أ. تأكّل من تركيب جميع الأحزمة بخطاء الرأس مع ضبط جميع أطوال الأحزمة على أوسع قياس.
- ب. شد الأحزمة الأطول إلى مشابك الفتح السريع.
2. يجب وضع دعامة الرقبة الموجودة في خطاء الرأس على رقبتك في وضع مريح.
- مهم - لا تضيق الأحزمة بشكل مفرط. أبدأ الارتداء والأحزمة في وضع فضفاض، ثم ضيق حسماً يلزم لتحقيق غلق مانع لتسرب الهواء.
3. اضبط الأحزمة السفلية بحيث تكون وصلة الأنف للقناع في وضع مريح على الشفة العلوية.
- أ. من المقيد أن تبرز مشابك قليلًا للخارج عند تضيق الأحزمة السفلية لضمان وضع القماش حول الشفتين وليس فوقهما.
5. وصل طرفًا واحدًا من أنبوب ضغط الهواء الإيجابي (PAP) والذي يبلغ طوله 9 بوصات، بجهاز ضغط الهواء الإيجابي (PAP).
6. شغل جهاز ضغط الهواء الإيجابي (PAP).
7. استقل في وضعية نومك الطبيعية، وإذا لزم الأمر، فأذر القناع بحيث يكون القماش مانعاً لتسرب بوضعه قلة الجلد.
- توجد نصائح إضافية خاصة بالضبط في القسم التالي، كما يمكن مشاهدة مقطع فيديو مفصل عن تركيب القناع عبر www.circadiance.com/help.

الضبط لمنع التسرب -

إذا واجهت مشكلات تسرب، فجرّب الخطوات التالية:

1. اضبط الأحزمة كما يلزم لتحقيق غلق مانع لتسرب ومرير.
2. حرك القناع قليلاً في مكانه من خلال تدويره من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل، وذلك بينما تدفع أنفك برق في فتحة الوصلة الأنفية بالقناع.

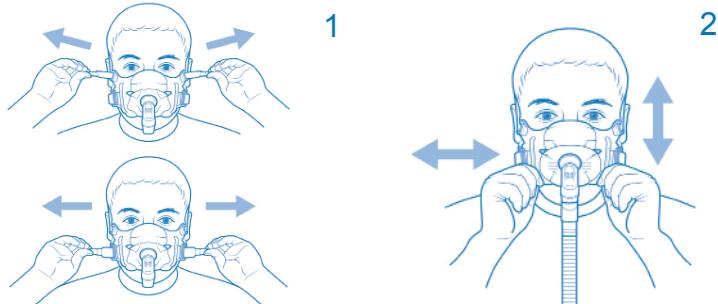

تنظيف القناع

- توصيل القناع بخطاء الرأس**
1. إذا لم يتم توصيل القناع بخطاء الرأس، فوصله على النحو التالي:
 أ. يقع المتصق الأبيض في الجزء الخلفي من خطاء الرأس.
 ب. وصل الأحزمة العلوية الأصفر بالجزء المخصص لأنف القناع.
 ج. شد الأحزمة الأطول إلى مشابك الفتح السريع.
 د. تأكّل من ضبط جميع أطوال الأحزمة على أوسع قياس من أجل عملية التركيب الأولى.



توصيل المرفق ذي الصمام المانع للاختناق (AVV) والمنحنى بزاوية 90°

1. مرر "العرق اللولبي" داخل الفتحة من داخل القناع.
2. ضع "الحلقة" فوق "العرق اللولبي".
3. تأكّل من أن القماش لا يغطي "العرق اللولبي".
4. اربط "الصامولة" بـ "العرق اللولبي".

يُعد المرفق ذو الصمام المانع للاختناق (AVV) والمنحنى بزاوية 90° من إحدى خصائص السلامة لأقصى حد SleepWeaver Anew 90°. لا تستخدم إلا صمام (AVV) المرفق مع القناع. لا تبتل أي مرافق أو صمام (AVV) آخر.

الفتح السريع

1. ضمّم قناع SleepWeaver Anew مزوّداً بمشبكين لفتح السريع لإزالة القناع سريعاً.
2. حُرِّب إزالة القناع وتوصيله مستخدماً مشبكَيْ الفتح السريع.

التحذيرات

- يُعد الجهاز قناعاً للتهوية، وينبغي عدم استخدامه مع دائرة تهوية مزدوجة الأنف.
- في حالة حدوث أي ردود فعل لأي من أجزاء هذا القناع أو خطاء الرأس، قتوقف عن الاستخدام على الفور.
- ينبغي عدم استخدام هذا النظام ما لم يكن جهاز العلاج في وضع التشغيل ويعمل بشكل صحيح.
- ينبغي عدم سد فتحات التهوية أبداً.
- تأكّل من ارتداء القناع بشكل صحيح. تأكّل من وضع القناع وخطاء الرأس وتراكبها كما هو موضح في الصفحة الأولى من هذه الإرشادات.
- في حال وجود أي تدهور ظاهر لأحد مكونات النظام (تشقّق أو قطع غيار مكسورة أو تمزقات، إلخ) أو استمرار اتساخ أي من المكونات بعد التنظيف، يجب التخلص من المكون واستبداله.
- قد يؤدي تغيير نمط تكرار عملية التنظيف أو الأسلوب أو المنظف المستخدم لتنظيف المنتج بخلاف ما تذكر تفصيلاً في هذه الإرشادات إلى التأثير سلباً على القناع، مما سيؤثّر سلباً على سلامنة عملية العلاج أو جودتها.
- في حال استخدام القناع مع النفس بالأكسجين الإضافي، يجب إيقاف تدفق الأكسجين إنما كان الجهاز لا يعمل؛ إذ يشكّل الأكسجين المترافق خطر نشوب الحريق.
- في حال استخدام القناع مع النفس بالأكسجين الإضافي، ينبغي أن يتبع المريض عن التدخين.
- للحد من الإصابة بالقيء أثناء النوم، ينبغي للمريض عدم تناول الطعام أو الشرب لمدة 3 ساعات قبل استخدام القناع.
- هذا القناع معد لإعادة الاستخدام من قبل مريض واحد فقط، وليس مُصرّحاً بإعادة معالجه (بطرق التنظيف والتقطير) في المراكز الطبية. ينبغي عدم اتباع سوى طرق التنظيف المذكورة في هذه الإرشادات لكل من المنازل والمراكز الطبية.
- لا تغلق أو تعطل صمام (AVV) بقناع SleepWeaver Anew 90°.
- لم يُصمّم القناع بغرض الاستخدام على المرضى غير المتعاونين أو الخاضعين لتأثير مسكن أو عديمي الاستجابة أو العاجزين عن إزالة القناع دون إشراف طبي.

1. ينبغي تنظيف قناع SleepWeaver Anew عن طريق الغسل اليدوي باستخدام صابون مخفف غير مسبّب للكشط في ماء دافئ مرّة كل يومين. لا تستخدم الماء الساخن مطلقاً. كرر الغسل حتى يبدو القناع نظيفاً. أغسل خطاء الرأس بيديك أسيوغاً.
2. اشطف جيداً بماء صالح للشرب، وجفّف القناع بعيداً عن التعرّض لأشعة الشمس.
3. يمكنك إبقاء المرفق ذي الصمام المانع للاختناق (AVV) والمنحنى بزاوية 90° متصلاً أثناء التنظيف، أو يمكنك إزالته وتنظيفه بشكل منفصل. ارجع إلى "توصيل المرفق ذي الصمام المانع للاختناق (AVV) والمنحنى بزاوية 90°" إذا أزّلت المرفق من أجل التنظيف.
- ضمّم الصمام المانع للاختناق للسماح بمرور الهواء إذا فقد النظام الضغط يجب على المستخدم التحقق من إمكانية تترك صمام (AVV) بين الموضع المفتوح والمغلق قبل كل استخدام. يجب على المستخدم تنظيف الصمام المانع للاختناق يومياً لضمان إزالة جميع الإفرازات والتأكّل من التقوّب التي تسمح بمرور الهواء ليست مغطاة أو مسدودة.
- لا تغلق صمام (AVV) أو تعلله.

افحص جميع قطع الغيار للتأكد من عدم وجود ثلف أو تأكّل بعد كل عملية تنظيف وقبل كل استخدام.

